



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง ขยายทอดตลาดครุภัณฑ์

ด้วยโรงพยาบาลท่าตะเกียบ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๙๗ รายการ โดยวิธีการประมูลขายปากเปล่า ดังรายละเอียดแนบท้าย

๑. ผู้สนใจและมีความประสงค์จะประมูล ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๘

๒. ผู้มาประมูลเสนอราคาต่ำกว่าราคาที่ประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินเป็นราคาต่ำสุด

๓. การขายโดยวิธีขยายทอดตลาด ประกอบด้วย

|                    |             |    |        |
|--------------------|-------------|----|--------|
| - ครุภัณฑ์ทั่วไป   | จำนวน       | ๓๔ | รายการ |
| - ครุภัณฑ์การแพทย์ | จำนวน       | ๖๓ | รายการ |
|                    | รวมทั้งสิ้น | ๙๗ | รายการ |

ผู้ประมูลสูงสุดให้ถือว่าเป็นผู้ประมูลได้ และจะต้องชำระเงินสดทันที

๔. กำหนดขยายทอดตลาด โดยวิธีปากเปล่าในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

๕. เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าประมูลสภาพพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกียบ จังหวัดเชียงใหม่

๖. เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มการประมูล

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมบัติ หังทอง)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายการครุภัณฑ์ทั่วไปชำรุด กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่าตะเกราบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ                                               | หมายเลขครุภัณฑ์       | จำนวน     | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ          |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| ๑        | ตู้ควบคุมโทรศัพท์ระบบตู้สาขาอัตโนมัติ                | ทดก 5805-002-0006/1   | ๑ ตู้     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒        | ตู้ควบคุมโทรศัพท์ระบบตู้สาขาอัตโนมัติ                | ทดก 5805-002-0006/2   | ๑ ตู้     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๓        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/38  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๔        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/68  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๕        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/73  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๖        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/75  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๗        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/76  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๘        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/77  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๙        | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/78  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๐       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/79  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๑       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/84  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๒       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/85  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๓       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/87  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๔       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/89  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๕       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/98  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๖       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/99  | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๗       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/100 | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๘       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/101 | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๑๙       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/103 | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๐       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/117 | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๑       | เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ มีใช้คนเก็บรับระดับได้ | ทดก 7110-006-0036/120 | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๒       | เก้าอี้ระดับ 3-6                                     | ทดก 7110-006-0002     | ๑ ตัว     | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๓       | เครื่องพิมพ์ชนิด Laser 107 a HP                      | ทดก 7440-021-0003/68  | ๑ เครื่อง | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๔       | เครื่องพิมพ์ Laser Canon LBP                         | ทดก 7440-021-0003/20  | ๑ เครื่อง | ๒๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๕       | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix LQ 310(Epson)            | ทดก 7440-003-0001/15  | ๑ เครื่อง | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๖       | เครื่องพิมพ์ชนิดสี Epson L220/C11 DE56501            | ทดก 7440-021-0005/6๖  | ๑ เครื่อง | ๒๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๗       | เครื่องสแกนเนอร์                                     | ทดก 7110-021-0007/2   | ๑ เครื่อง | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๘       | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix LQ 300/500               | ทดก 7440-003-0001/11  | ๑ เครื่อง | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๒๙       | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก                                  | ทดก 7440-012-0007/10  | ๑ เครื่อง | ๑๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |

ลงชื่อ พนิดา สุลาภา ประธานกรรมการ  
(นางสาวพนิดา สุลาภาวิฑูรณ์)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ อ. วิไลลักษณ์ กรรมการ  
(นางสาววิไลลักษณ์ ชันธคามโกษก)  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ลงชื่อ พ.ร. รุ่งแสงสี กรรมการ  
(นายณภัต รุ่งแสงสี)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ



| ลำดับที่                       | รายการ                                             | หมายเลขครุภัณฑ์     | จำนวน     | ราคาประเมิน (บาท) | หมายเหตุ          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| ๓๐                             | โปรเจคเตอร์ Acer                                   | ทดก 6730-012-0001/2 | ๑ เครื่อง | ๓๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๓๑                             | โทรทัศน์สี ขนาด 40 นิ้ว จอ LED ยี่ห้อ SAMSUNG      | ทดก 7730-003-0009/1 | ๑ เครื่อง | ๕๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๓๒                             | โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จอ LCD ยี่ห้อ TOSHIBA HV10 | ทดก 7730-003-0007/2 | ๑ เครื่อง | ๓๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๓๓                             | โทรทัศน์สี ขนาด 32 นิ้ว จอ LED ยี่ห้อ TOSHIBA      | ทดก 7730-003-0007/4 | ๑ เครื่อง | ๓๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| ๓๔                             | เครื่องซักผ้าขนาด 8 กิโลกรัม ยี่ห้อ Panasonic      | ทดก 3510-012-0005/1 | ๑ เครื่อง | ๕๐.๐๐             | ชำรุดใช้การไม่ได้ |
| รวมเป็นเงิน ( ห้าร้อยบาทถ้วน ) |                                                    |                     | ๓๔ รายการ | ๕๐๐.๐๐            |                   |




ลงชื่อ พนิต สุขลาภิตยา ประธานกรรมการ  
(นางสาวพนิตา สุขลาภิตยาคุณ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ ศิริลักษณ์ กรรมการ  
(นางสาววิไลลักษณ์ ชันธคามโกชก)  
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ



ลงชื่อ นภัทร รุ่งแสงสี กรรมการ  
(นายณภัต รุ่งแสงสี)  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ





ตู้ควบคุมโทรศัพท์รายการที่ 1 - 2

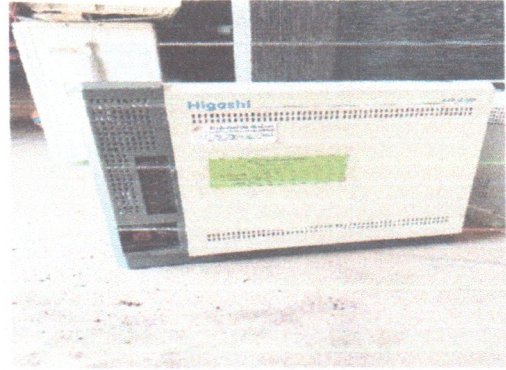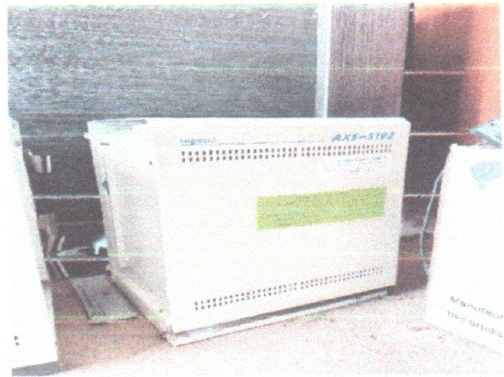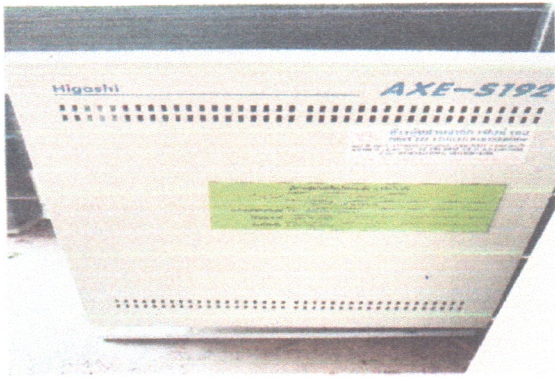

เก้าอี้รายการที่ 3 - 22

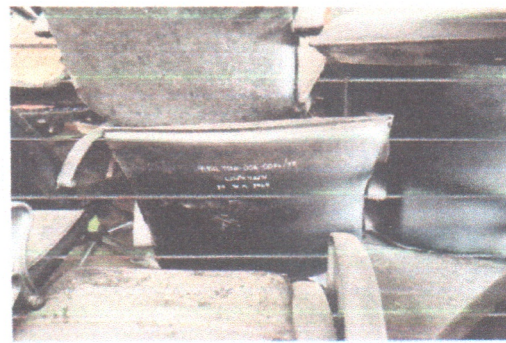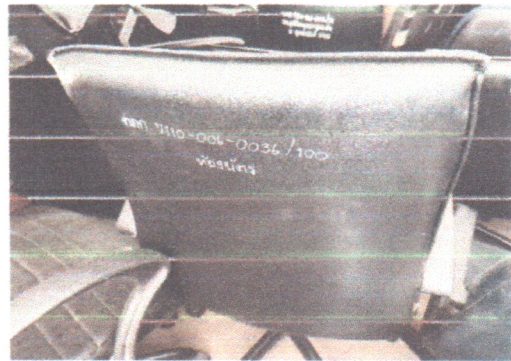




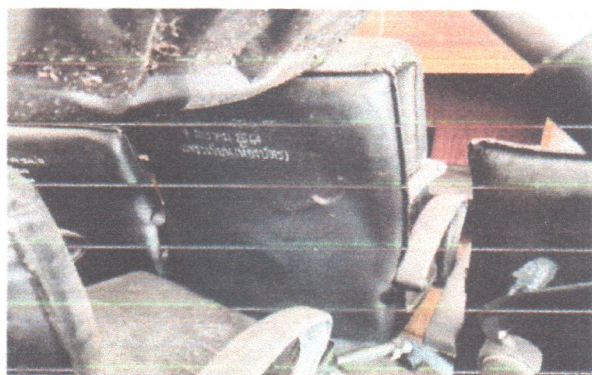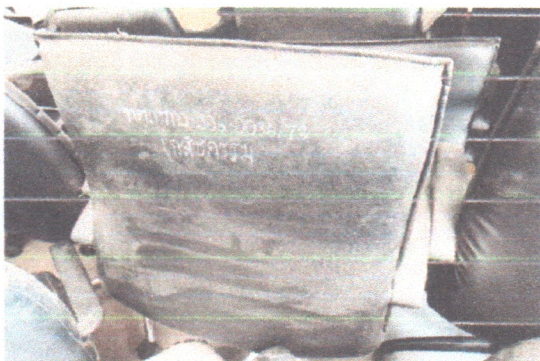





เครื่องพิมพ์รายการที่ 23

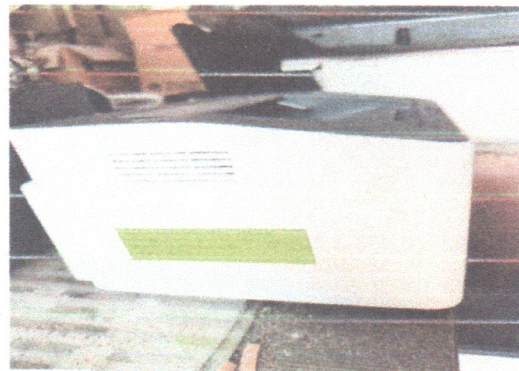


เครื่องพิมพ์รายการที่ 24



เครื่องพิมพ์รายการที่ 25

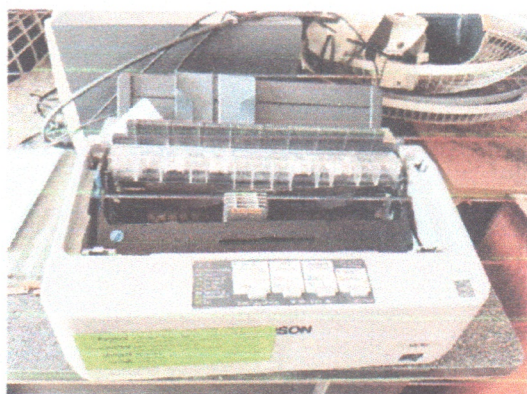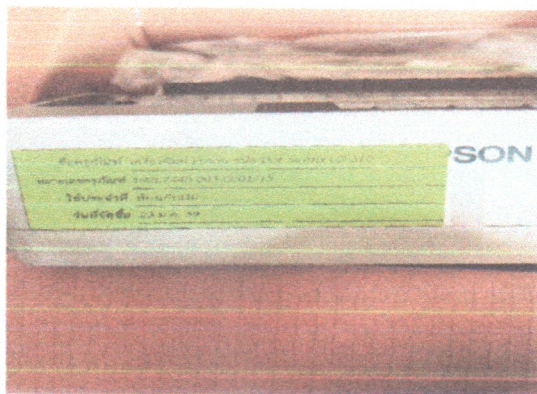

เครื่องพิมพ์รายการที่ 26

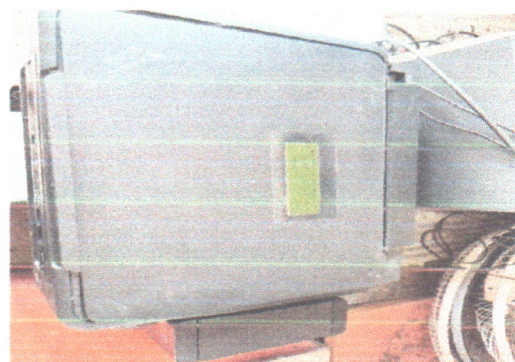



เครื่องสแกนเนอร์รายการที่ 27




เครื่องพิมพ์รายการที่ 28



โน้ตบุ๊กรายการที่ 29




โปรเจคเตอร์รายการที่ 30

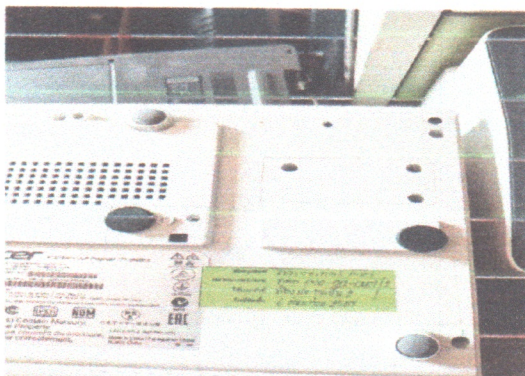






โทรทัศน์สีรายการที่ 31

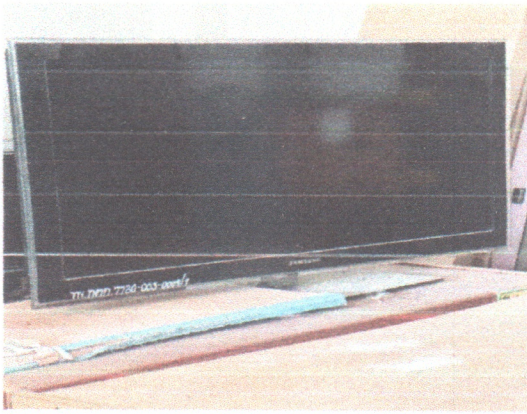

โทรทัศน์สีรายการที่ 32

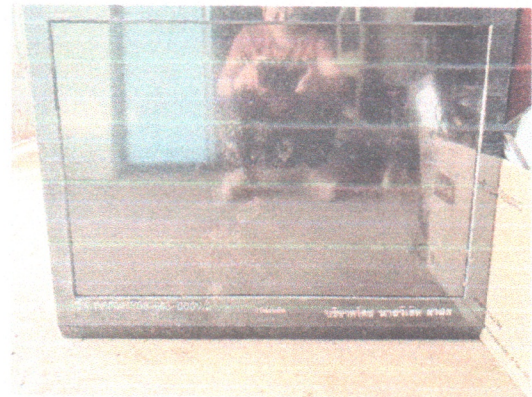

โทรทัศน์สีรายการที่ 33

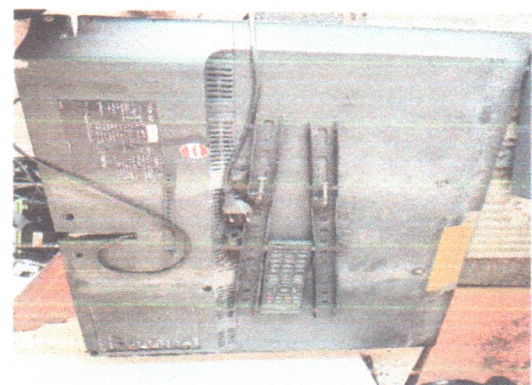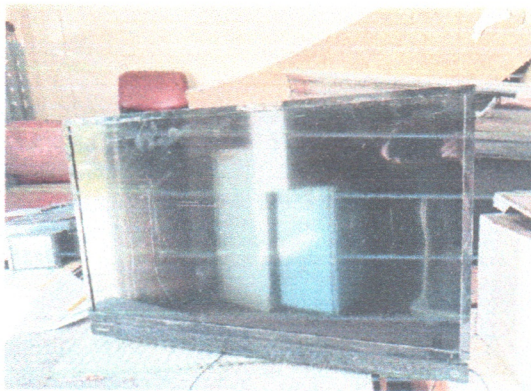

เครื่องซักผ้ารายการที่ 34





รายการครุภัณฑ์การแพทย์ชำรุด โรงพยาบาลท่าตะเกียบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | รายการ                                            | หมายเลขครุภัณฑ์           | จำนวน | ราคาประเมิน | ราคาประเมินรวม | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------|----------------|----------|
| ๑        | Long Spine Board Setพร้อมชุดล็อกศีรษะ             | ทตท.6530-038-4210/4ค.     | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๒        | Long Spine Board Setพร้อมชุดล็อกศีรษะ             | ทตท.6530-038-4210/5ค.     | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๓        | เครื่องดึงคอหรือหลังแบบอัตโนมัติ                  | ทตท.6530-004-1103/1ค.     | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๔        | เครื่องตรวจวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด       | ทตท.6515-038-0006/24      | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๕        | เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง                        | ทตท.6515-031-0201/1ค.     | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๖        | เครื่องปั่นตกตะกอน24หลอด                          | ทตท.6515-014-2024/4 ค.    | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๗        | ตู้เย็นเก็บเลือด                                  | ทตท.6515-038-2151/1ค.     | ๑     | ๕๐๐.๐๐      | ๕๐๐.๐๐         |          |
| ๘        | เครื่องวัดระดับความแข็งตัวของเลือด                | ทตท.6515-007-0001/1ค.     | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๙        | เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด           | ทตท.6515-025-1001/2ค.     | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๑๐       | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแบบแสดงตัวเลข   | ทตท.6585-013-0002/38      | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๑๑       | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติแบบแสดงตัวเลข   | ทตท.6585-013-0002/42      | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๑๒       | เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ                        | ทตท.6515-003-3121/20-21ว. | ๒     | ๑๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๑๓       | เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ                        | ทตท.6515-056-0002/27ว     | ๑     | ๑๐.๐๐       | ๑๐.๐๐          |          |
| ๑๔       | เครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ                        | ทตท.6515-003-3121/28ว     | ๑     | ๑๐.๐๐       | ๑๐.๐๐          |          |
| ๑๕       | เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่                    | ทตท.6515-003-2102/1       | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๑๖       | เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่                    | ทตท.6515-003-2102/2       | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๑๗       | เครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่                    | ทตท.6515-003-2102/3       | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๑๘       | ถังออกซิเจน(ถังใหญ่)                              | ทตท.6530-037-0001/3       | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๑๙       | ถังออกซิเจน(ถังใหญ่)                              | ทตท.6530-037-0001/8       | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๐       | เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร                        | ทตท.6515-003-5501/5       | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๑       | เครื่องทำคลอดสุญญากาศ                             | ทตท.6515-045-0001/2       | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๒       | เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก                          | ทตท.6515-053-0001/2ค.     | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๓       | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ                | ทตท.6515-029-0101/10ค.    | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๒๔       | เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ                | ทตท.6515-029-0101/15ว.    | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๒๕       | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ Biphasic               | ทตท 6515-027-3002/6ค.     | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๖       | เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบ Biphasic               | ทตท 6515-027-3002/7ค.     | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๗       | เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติชนิด 3 ช่อง | ทตท 6515-027-1003/3ค.     | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |
| ๒๘       | เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนที่ได้                  | ทตท. 6515-037-0003/6ค.    | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๒๙       | เครื่องดูดเสมหะชนิดเคลื่อนที่ได้                  | ทตท. 6515-037-0003/7ค.    | ๑     | ๑๐๐.๐๐      | ๑๐๐.๐๐         |          |
| ๓๐       | เครื่องมือส่องหลอดลม                              | ทตท.6515-022-3101/10ค.    | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๓๑       | เครื่องมือส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออปติก              | ทตท.6515-022-3101/12ค.    | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๓๒       | เครื่องมือส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออปติก              | ทตท.6515-022-3101/14ค.    | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๓๓       | เครื่องมือส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออปติก              | ทตท.6515-022-3101/15ค.    | ๑     | ๕๐.๐๐       | ๕๐.๐๐          |          |
| ๓๔       | ยูนิตทำฟัน                                        | ทตท.6520-007-0001/3ค.     | ๑     | ๕,๐๐๐.๐๐    | ๕,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๓๕       | ยูนิตทำฟัน                                        | ทตท.6520-007-0001/4ค.     | ๑     | ๕,๐๐๐.๐๐    | ๕,๐๐๐.๐๐       |          |
| ๓๖       | โคมไฟส่องปากทางทันตกรรม                           | ทตท.6530-005-1111/2       | ๑     | ๑๐.๐๐       | ๑๐.๐๐          |          |
| ๓๗       | โคมไฟส่องปากกระเป๋าทัว                            | ทตท.6530-005-1111/4ค.     | ๑     | ๑๐.๐๐       | ๑๐.๐๐          |          |
| ๓๘       | โคมไฟส่องปากกระเป๋าทัว                            | ทตท.6530-005-1111/5ค.     | ๑     | ๑๐.๐๐       | ๑๐.๐๐          |          |
| ๓๙       | เครื่องอุ่นเชื้อชนิดอ่านผล                        | ทตท.6530-003-4323/2       | ๑     | ๒๐.๐๐       | ๒๐.๐๐          |          |
| ๔๐       | เตียงเพอร์เลอร์                                   | ทตท.6530-001-0003/42      | ๑     | ๒๐๐.๐๐      | ๒๐๐.๐๐         |          |



|             |                                        |                         |    |        |           |  |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------|----|--------|-----------|--|
| ๔๑          | เตียงฟาว์เลอร์                         | ทตท.6530-001-0003/48ค.  | ๑  | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐    |  |
| ๔๒          | เตียงฟาว์เลอร์                         | ทตท.6530-001-0003/54/55 | ๒  | ๒๐๐.๐๐ | ๔๐๐.๐๐    |  |
| ๔๓          | เครื่องซังน้ำหนักตั้งพื้นแบบแสดงตัวเลข | ทตท.6530-008-0511/5ว.   | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๔๔          | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตั้งโต๊ะ     | ทตท.6515-069-0002/7     | ๑  | ๑๐.๐๐  | ๑๐.๐๐     |  |
| ๔๕          | เครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค             | ทตท.6515-003-4505/1-2   | ๒  | ๕.๐๐   | ๑๐.๐๐     |  |
| ๔๖          | รถเข็นเด็กทารก                         | ทตท.6530-038-4444/1     | ๑  | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐    |  |
| ๔๗          | โต๊ะคร่อมเตียง พับเก็บได้              | ทตท.6530-034-1002/2     | ๑  | ๕๐.๐๐  | ๕๐.๐๐     |  |
| ๔๘          | เกจออกซิเจนระบบไปป์ไลน์                | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๑๐.๐๐  | ๑๐.๐๐     |  |
| ๔๙          | เกจออกซิเจนถัง                         | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๑๐.๐๐  | ๑๐.๐๐     |  |
| ๕๐          | เครื่องผลิตออกซิเจน 5 ลิตร             | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐    |  |
| ๕๑          | ถังออกซิเจน(ถังเล็ก)                   | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๒  | ๑๐๐.๐๐ | ๒๐๐.๐๐    |  |
| ๕๒          | เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง      | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๕๓          | เครื่องดูดเสมหะ                        | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๕๔          | เครื่องช่วยหายใจ                       | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐    |  |
| ๕๕          | เครื่องกรองอากาศ                       | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๕๖          | เครื่องซังน้ำหนักตั้งพื้นแบบแสดงตัวเลข | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๕๗          | ชุดช่วยเดิน 6 อัน                      | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๖  | ๒๐.๐๐  | ๑๒๐.๐๐    |  |
| ๕๘          | เครื่องสำรองไฟเครื่องตรวจจอประสาทตา    | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๕๙          | เตียงนอนพับได้                         | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๒๐.๐๐  | ๒๐.๐๐     |  |
| ๖๐          | ที่นอนพร้อมปลั๊กม 1 ชุด                | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๑๐.๐๐  | ๑๐.๐๐     |  |
| ๖๑          | ที่วัดสวนสูงแบบไม้ 1 ชุด               | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๕.๐๐   | ๕.๐๐      |  |
| ๖๒          | ตู้ข้างเตียงแบบไม้ 3 อัน               | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๓  | ๕.๐๐   | ๑๕.๐๐     |  |
| ๖๓          | หน้าจอเครื่องอัลตราซาวด์ 1 อัน         | ไม่มีเลขครุภัณฑ์        | ๑  | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐    |  |
| รวมเป็นเงิน |                                        |                         | ๗๔ |        | ๑๕,๕๙๐.๐๐ |  |

(ลงชื่อ).....ฉัตร ใจดี.....ประธานกรรมการ  
(นางสาวมัทธา ชัยดี)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรณ.....กรรมการ  
(นางสาวรารามณ์ เสี่ยงล้ำ)  
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....จรัส.....กรรมการ  
(นายประวิทย์ มั่นอยู่คง)  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ



## ปีงบประมาณ 2567





